

## NOTA DE ATUALIZAÇÃO 1.45.0

A nova versão da plataforma Arkmeds traz melhorias, ajustes e correções de falhas com o objetivo de melhorar a sua experiência de uso do sistema. Abaixo, seguem as novidades incorporadas ao software nessa versão:

### 01 Implementação da preferência “Pode visualizar registros automáticos”

#### Pode visualizar registros automáticos

*O sistema gera alguns registros automáticos como na abertura de chamados e na assinatura da ordem de serviço. Esses podem ser visualizados pelo usuário ou não.*



## 02 Possibilidade de assinar ordens de serviço como segundo solicitante




The screenshot shows the 'Ordens de Serviço' (Service Orders) interface. At the top, there are buttons for '+ Adicionar' and '+ Adicionar lote'. Below these are icons for editing, calendar, document, trash, filter, settings, and a search bar labeled 'Pesquisar'. A dropdown menu is open, listing four signing options: 'Assinar como responsável técnico', 'Assinar como solicitante', 'Assinar como segundo solicitante' (highlighted with a red box), and 'Assinar como Responsável técnico / Engenheiro Clínico (3ª assinatura)'. Below the menu, a table lists two service orders with their respective IDs and status.

Assinar como responsável técnico
Assinar como solicitante
<b>Assinar como segundo solicitante</b>
Assinar como Responsável técnico / Engenheiro Clínico (3ª assinatura)

<input checked="" type="checkbox"/>			<a href="#">2019000000014510</a>	Aberta	
<input checked="" type="checkbox"/>			<a href="#">2019000000014509</a>	Aberta	

## 03 Possibilidade de editar informações de peças na criação da ordem de serviço

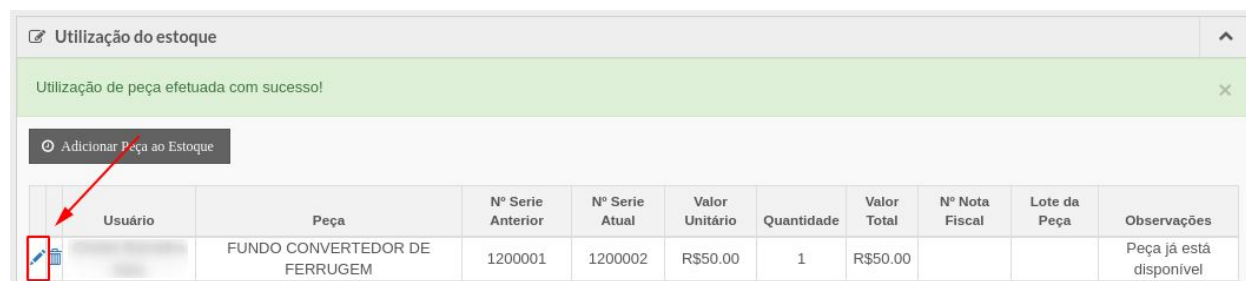

The screenshot shows the 'Utilização do estoque' (Inventory Usage) interface. At the top, there is a green notification bar that says 'Utilização de peça efetuada com sucesso!'. Below this is a button labeled 'Adicionar Peça ao Estoque'. A table displays the inventory details for a specific item.

Usuário	Peça	Nº Serie Anterior	Nº Serie Atual	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Nº Nota Fiscal	Lote da Peça	Observações
	FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM	1200001	1200002	R\$50.00	1	R\$50.00			Peça já está disponível

# 04 Criação da ficha vida de equipamento disponível para impressão


### 1 - Dados básicos

Estado:	Ativo
Tipo:	ABX MICROS 60
Número de série:	0404040404
Uso em calibrações:	Equipamento
Proprietário:	[REDACTED]

### 2 - Histórico ordem de serviço

Ordem de serviço nº 2019000000014508	
ID	98975
Estado	Aberta
Solicitante	[REDACTED]
Responsável	[REDACTED]
Tipo de serviço	Teste de Segurança Elétrica
Data de criação	10/03/20 03:00
Prioridade	Não urgente

# 05 Ao logar na plataforma como solicitante, é possível visualizar os contratos

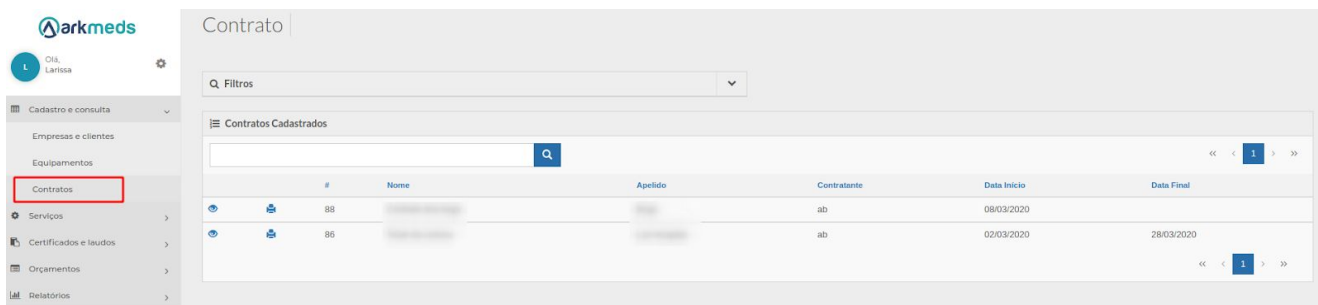

The screenshot displays the 'Contratos' (Contracts) section of the Arkmeds platform. The left sidebar shows the navigation menu with 'Contratos' highlighted. The main content area shows a table of registered contracts. The table has columns for ID, Nome (Name), Apellido (Surname), Contratante (Contractor), Data Inicio (Start Date), and Data Final (End Date). Two contracts are visible in the list.

#	Nome	Apellido	Contratante	Data Inicio	Data Final
88	[REDACTED]	[REDACTED]	ab	08/03/2020	
86	[REDACTED]	[REDACTED]	ab	02/03/2020	28/03/2020

## 06 Correção de falhas

- Correção no campo “Valor de Compra (R\$)” no cadastro de equipamentos;
- Adição de limitador de caracteres no campo “Pesquisar” na consulta de contratos;
- Adição de limitador de caracteres nos campos “Nome”, “Apelido” e “Contratante” presentes no filtro de consulta de contratos;
- Implementação de máscara de valor no campo “Valor Mensal (R\$)” presente no cadastro de contratos;
- Adição de limitador de caracteres nos campos “Descrição”, “Obrigações” e “Observações” presentes no cadastro de contratos;
- Padronização do campo “Vida Útil em anos” presente no filtro avançado da consulta de equipamentos, para que o mesmo aceite apenas números e tenha um limitador de caracteres;
- Implementação de máscara de valor no campo “Valor compra (R\$)” presente no filtro avançado da consulta de equipamentos;
- Retirada dos campos “Tempo de fechamento” e “Tempo de atendimento” do filtro avançado de consulta de equipamentos;
- Implementação de máscara de valor no campo “Valor Residual (R\$)” presente no filtro avançado de consulta de equipamentos;
- Adição de limitador de caracteres nos campos “Proprietário”, “Identificação”, “Portaria Inmetro”, “Fabricante”, “Descrição da Criticidade”, “Contratante”, “Tipo”, “Número de série”, “Patrimônio”, “Modelo” e “ID” presentes nos filtros avançados da consulta de equipamentos;
- Tradução de mensagem e campos em inglês que estavam presentes na adição de múltiplos equipamentos;
- Adição de limitador de caracteres nos campos “Fabricante” e “Modelo” presentes no cadastro de múltiplos equipamentos;
- Correção no envio automático de emails quando o status de uma ordem de serviço é alterado;
- Ajuste na análise de calibração para que não ocorra erro 500.